



VISTA DA LATO 1 / VUE DE ZONE 1

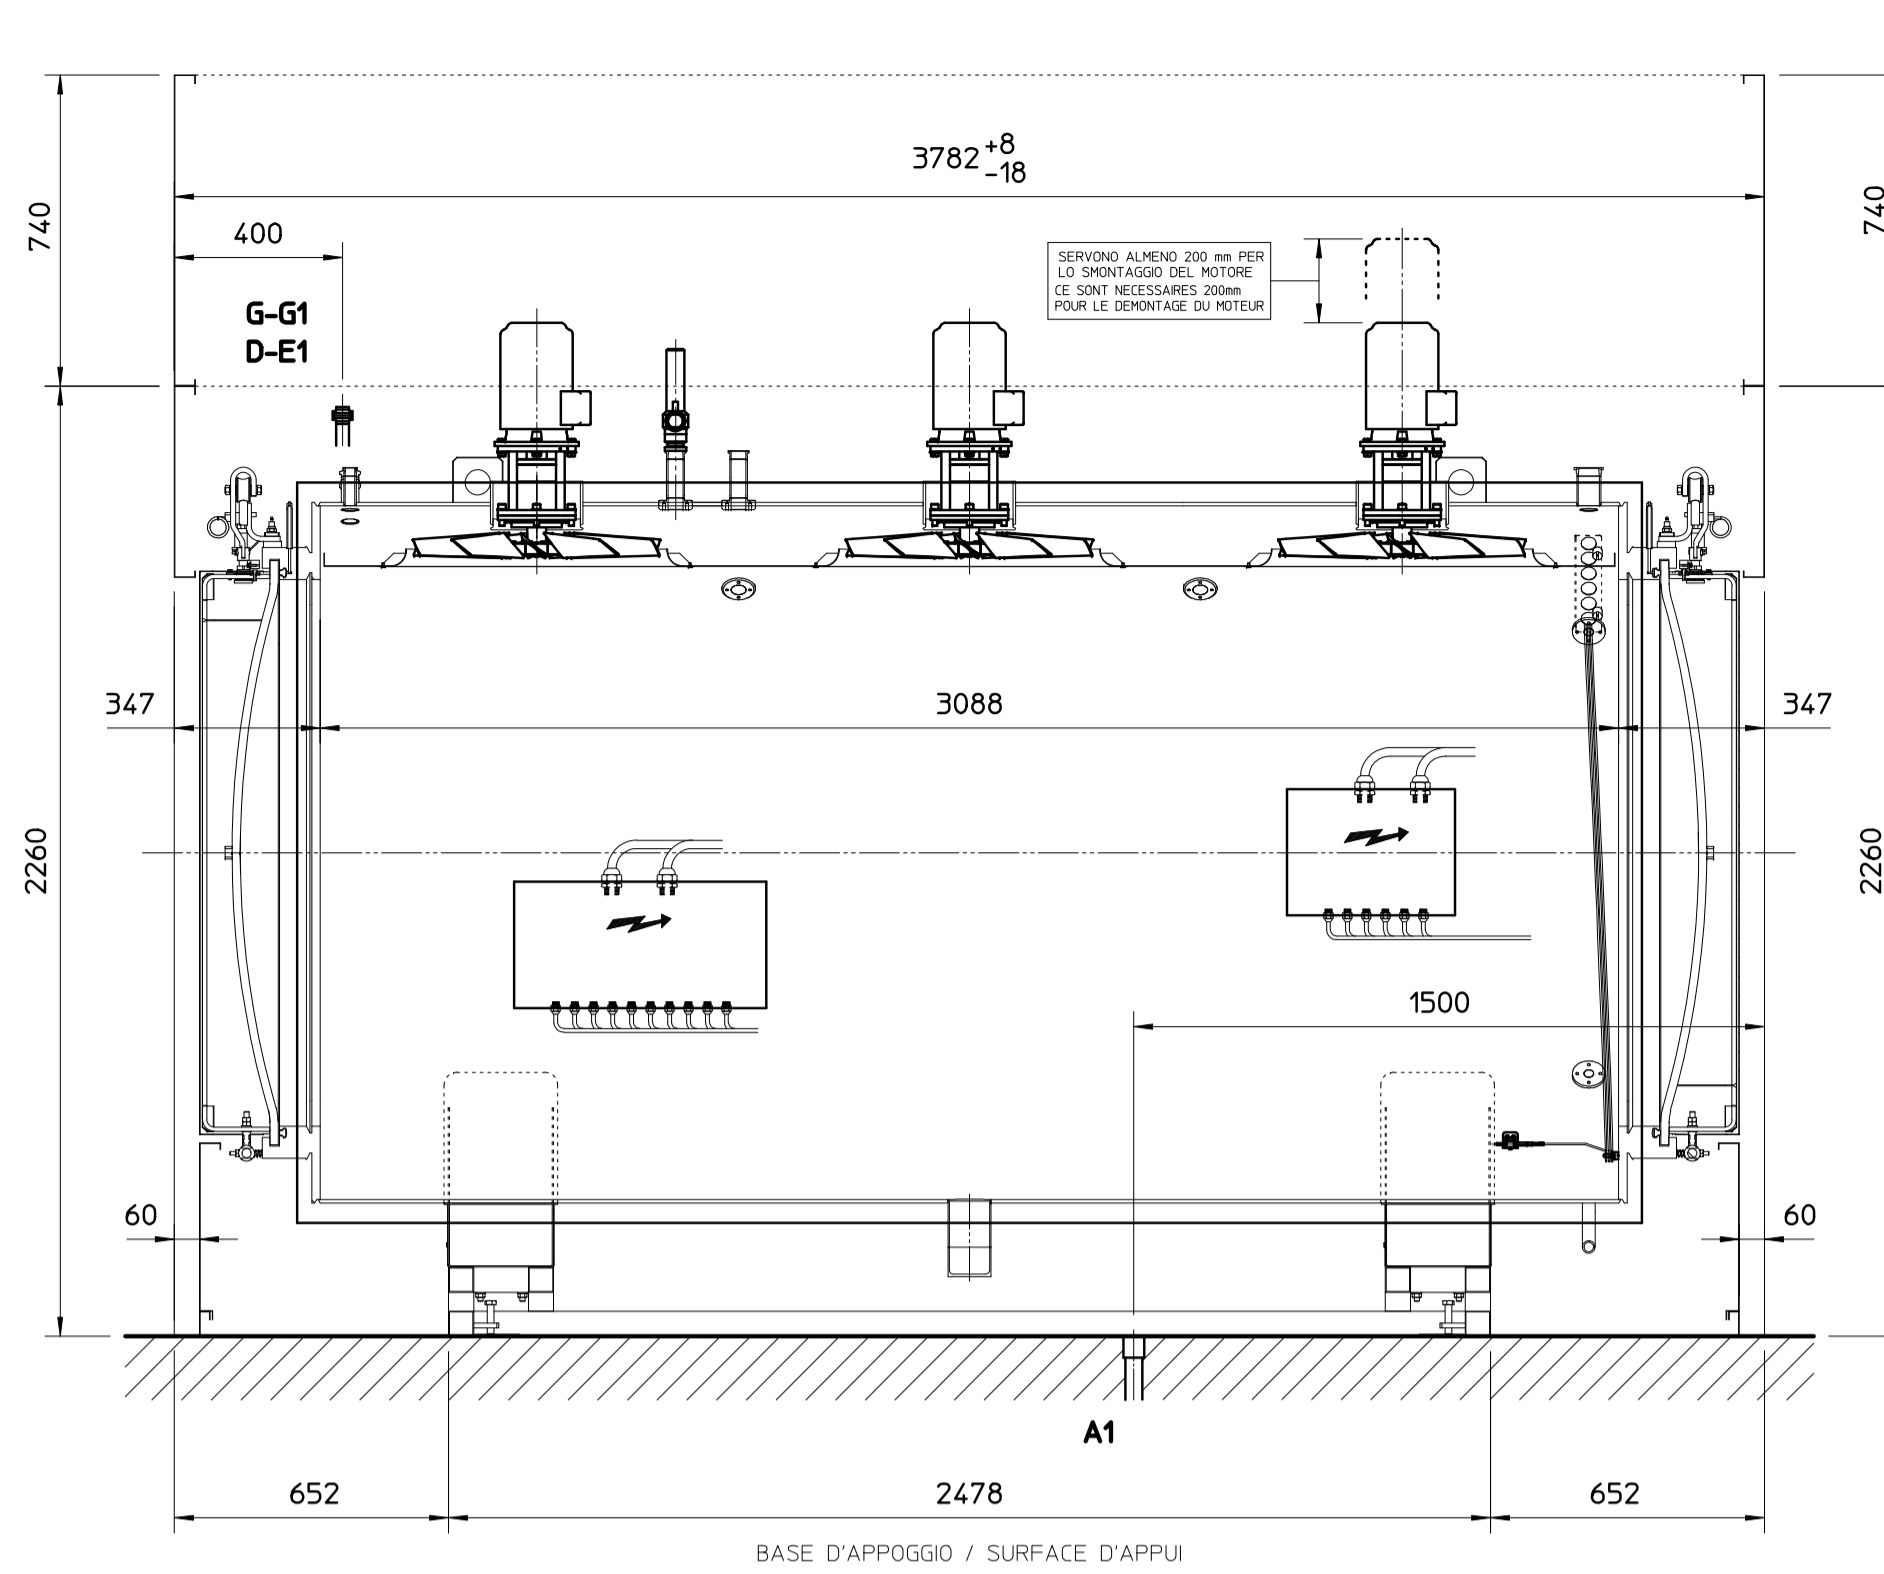


ZONE 2

VISTA DA 'Y' / VUE DE 'Y'

ZONE 1

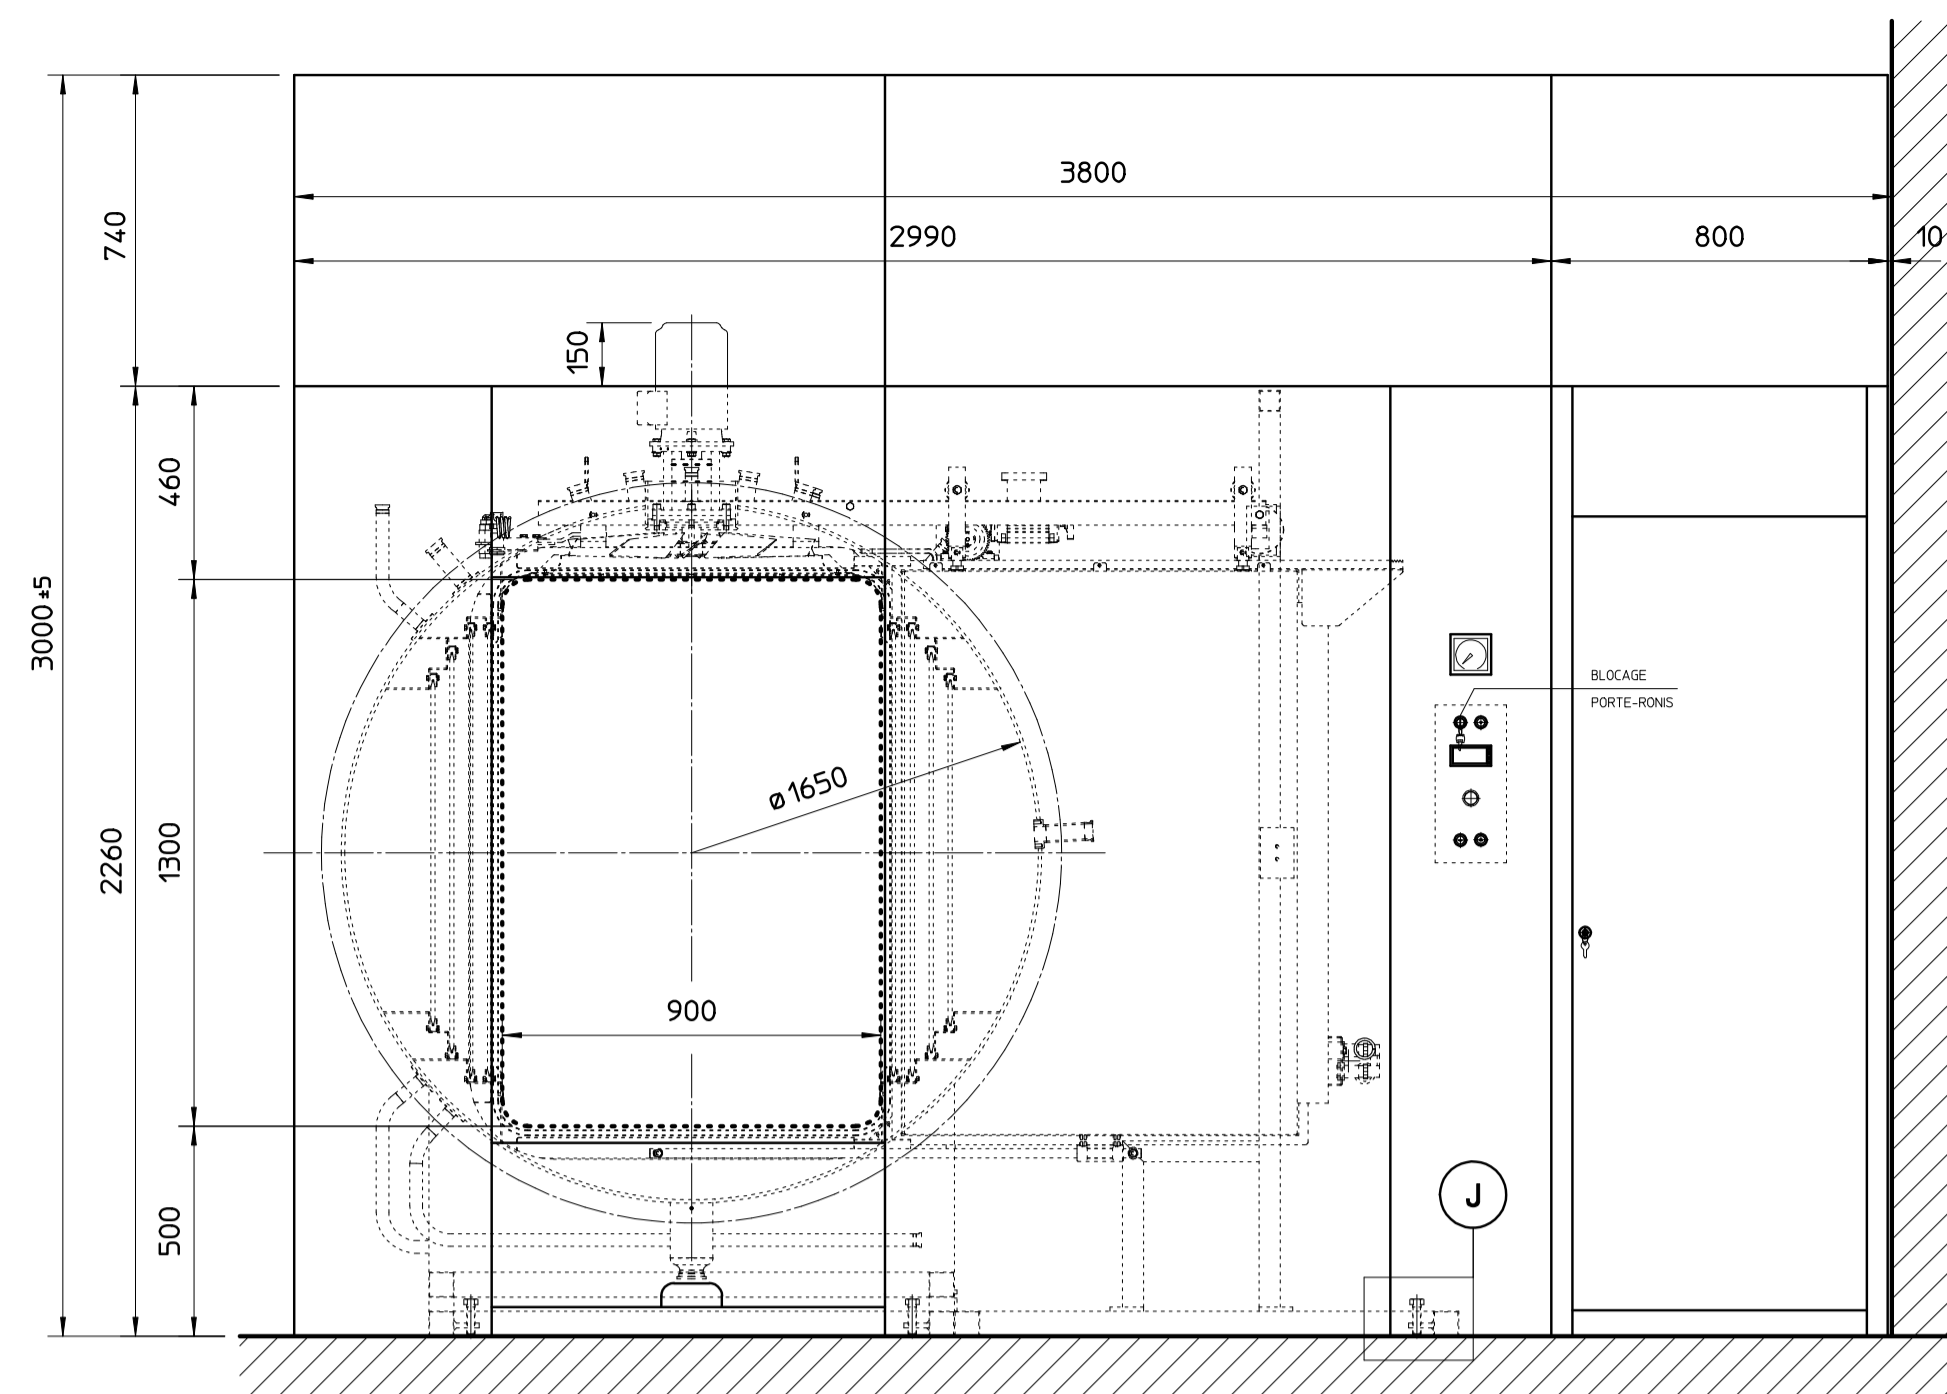






VISTA DA LATO 2 / VUE DE ZONE 2

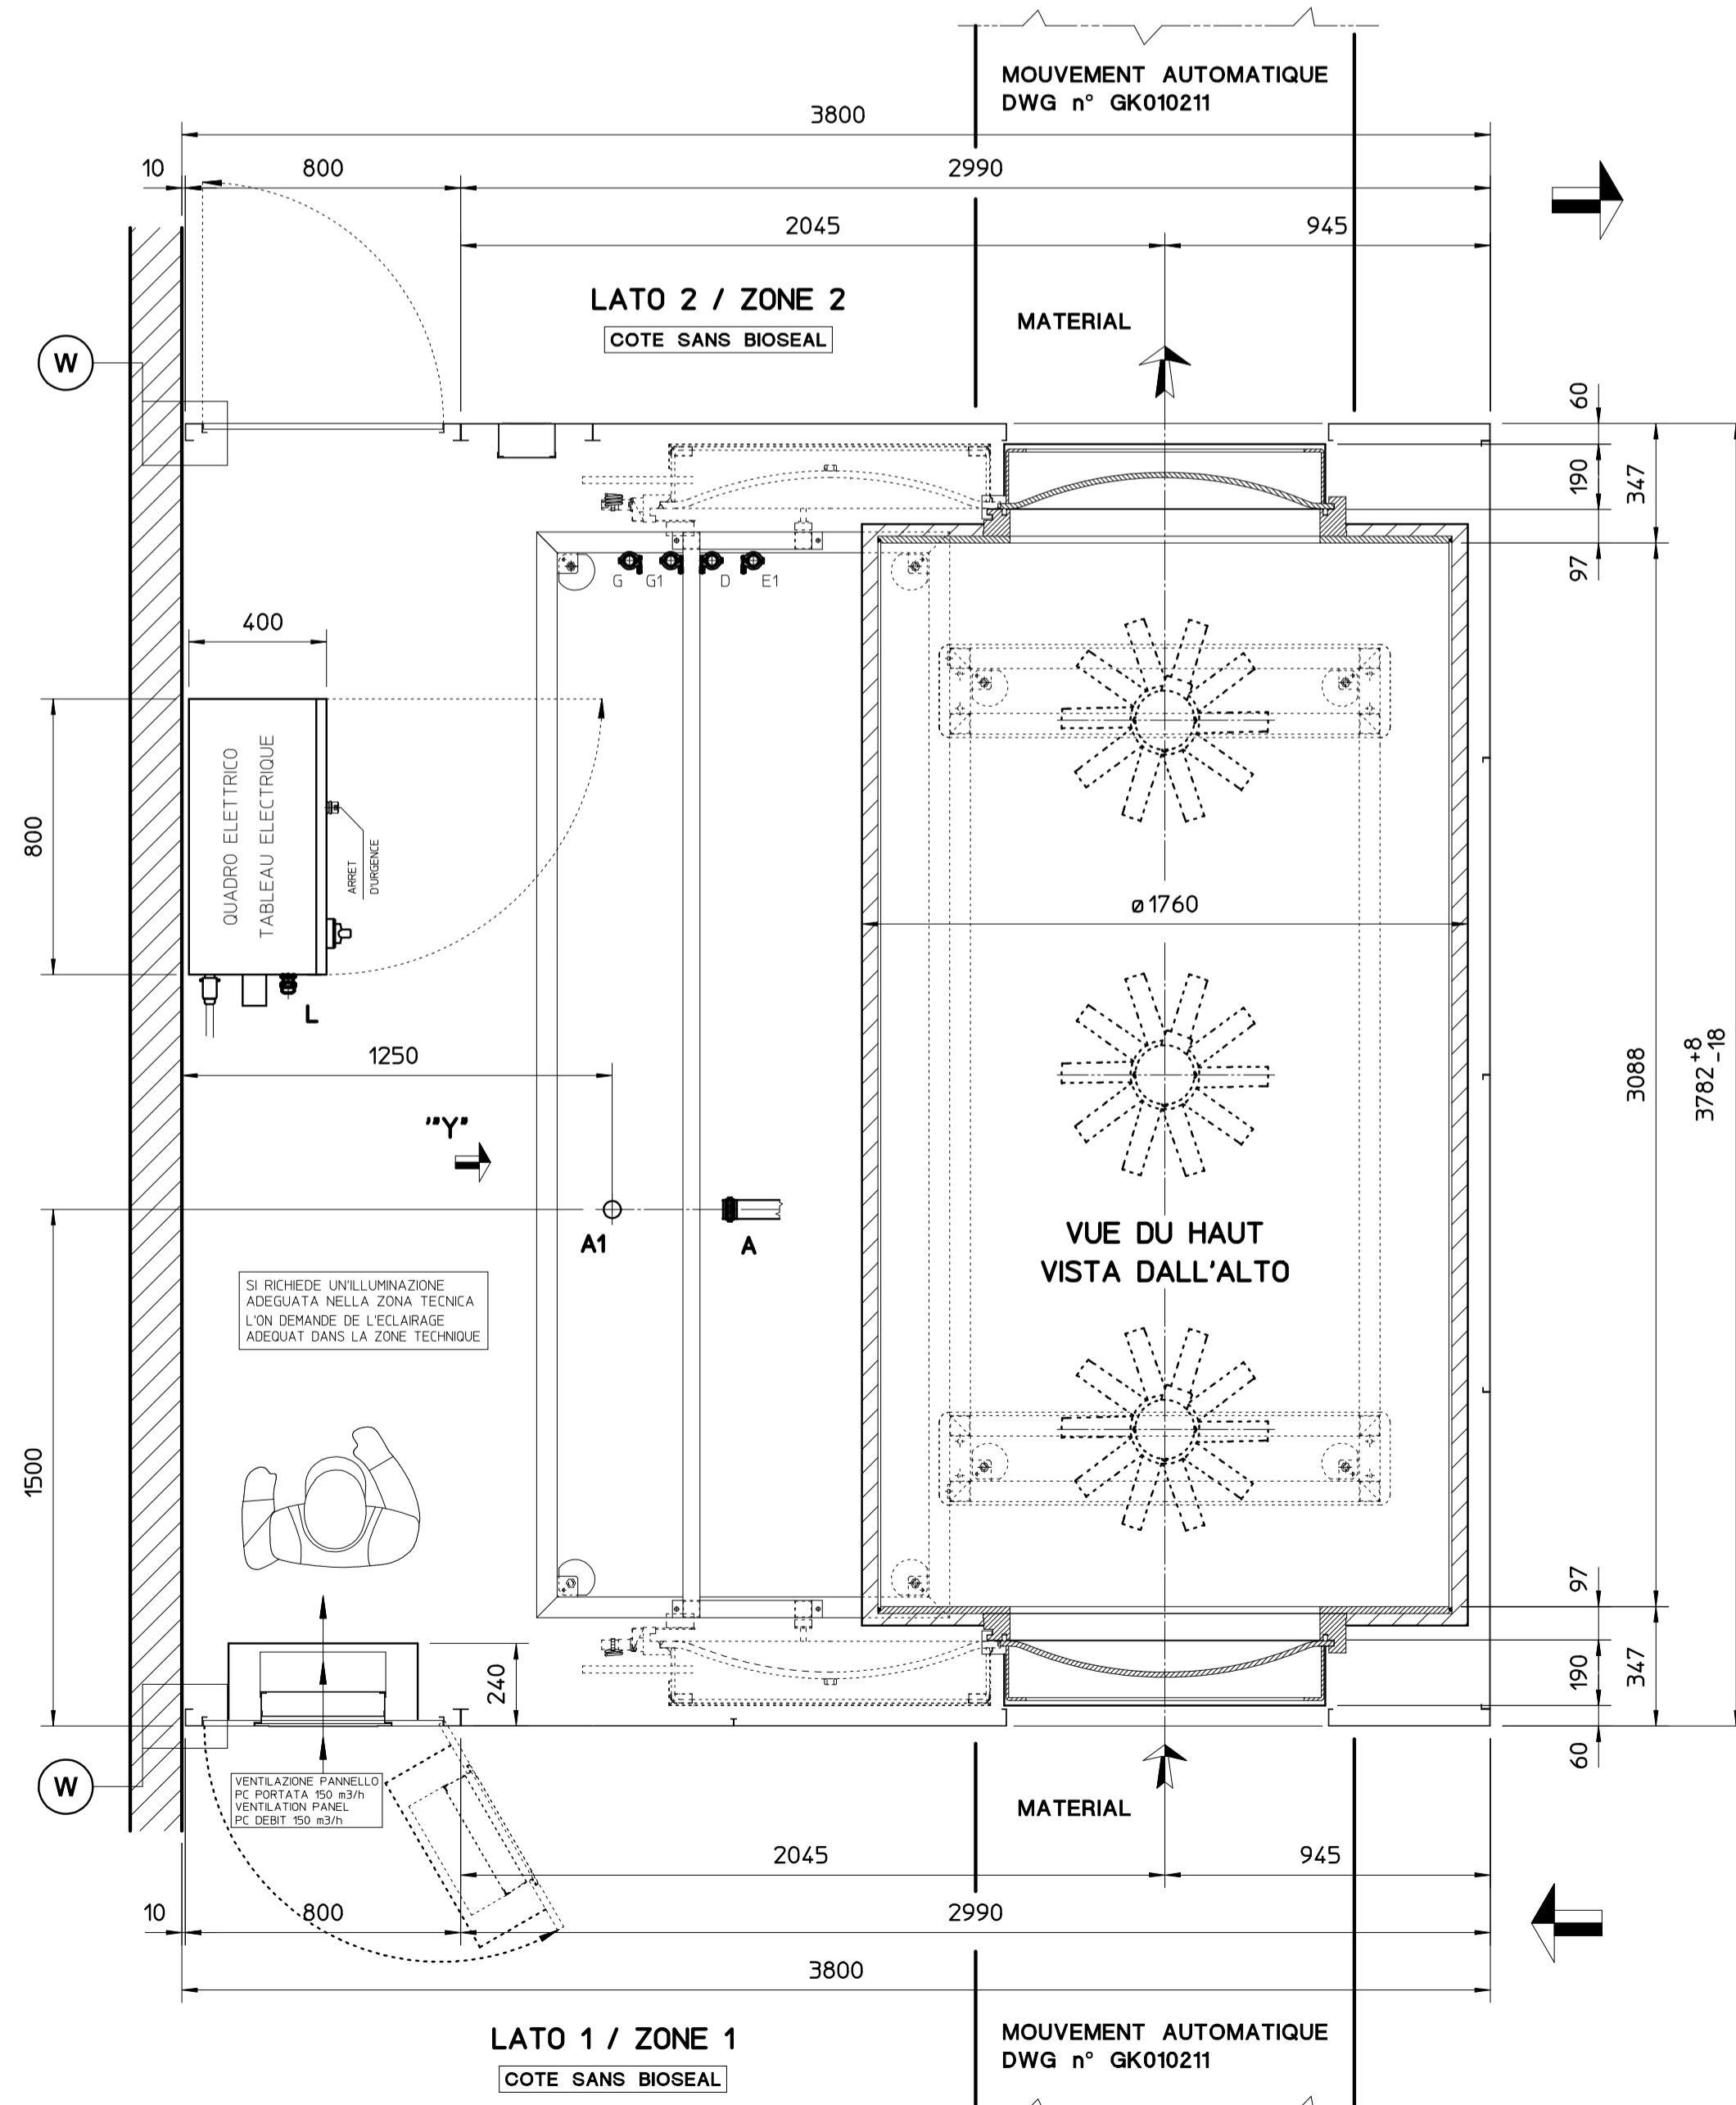


LATO 1 / ZONE 1

MOUVEMENT AUTOMATIQUE DWG n° GK010211

DISPOSITIVO PER LIVELLAMENTO AUTOCLAVE / DISPOSITIF POUR NIVELER L'AUTOCLAVE

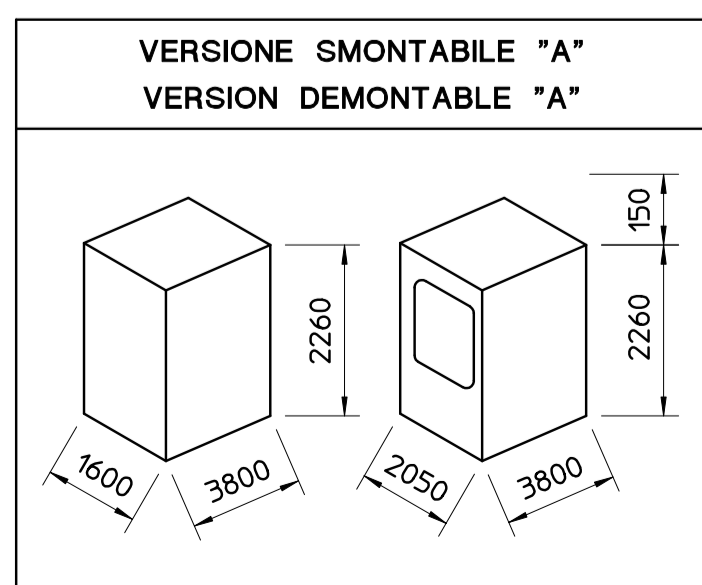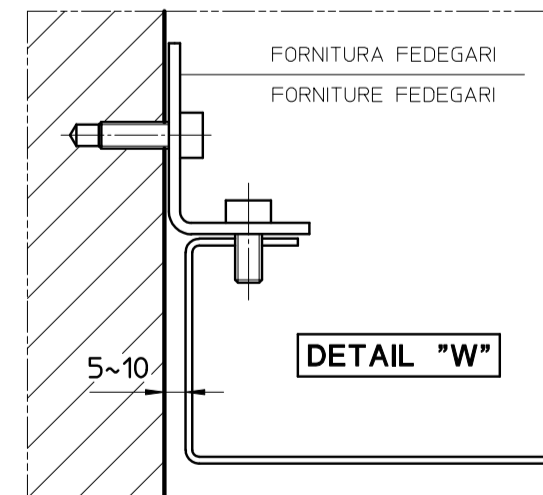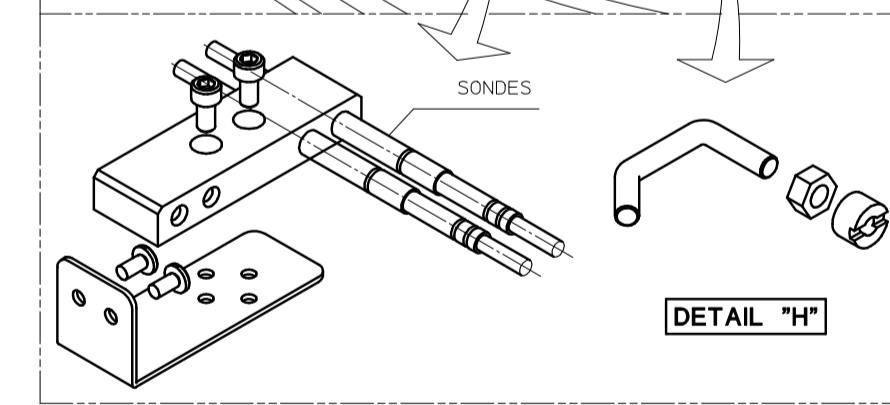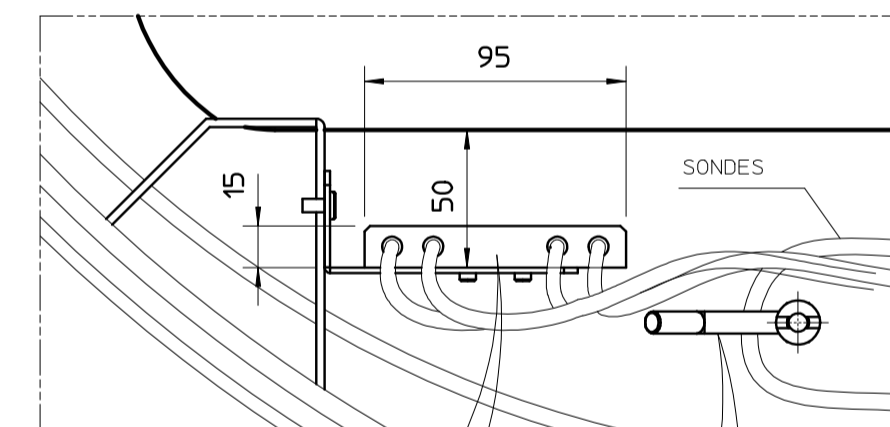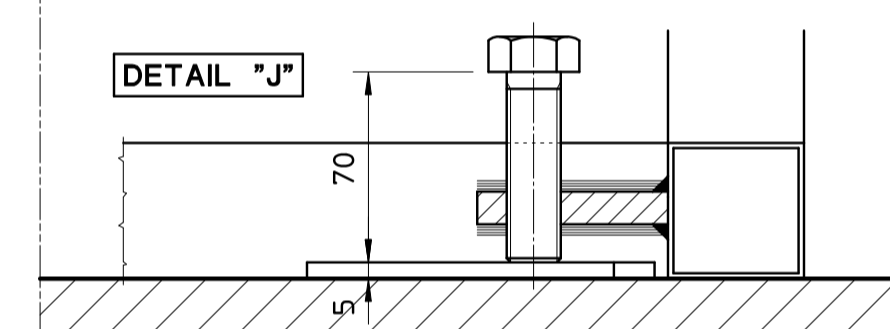

CONDIZIONI AMBIENTALI RICHIESTE PER L'INSTALLAZIONE		CONDITIONS DE L'AMBIANCE DEMANDEES POUR L'INSTALLATION	
TEMPERATURA AMBIENTE per l'area di installazione della macchina incluso vano tecnico ed armadio elettrico	TEMPERATURE de la salle d'installation de la machine, zone technique et tableau électrique inclus.	5 - 40°C (comunicare eventuali differenze) (priere communiquer d'éventuelles différences)	
UMIDITA' RELATIVA MAX.	HUMIDITE RELATIVE MAX.	85%, T≤40°C	
CONCENTRAZIONE MAX. DI POLVERE (particelle ø 0,5 micron)	CONCENTRATION MAX. DE POUSSIERE (particules ø 0,5 micron)	MAX: 2x10 ⁶ /cf	

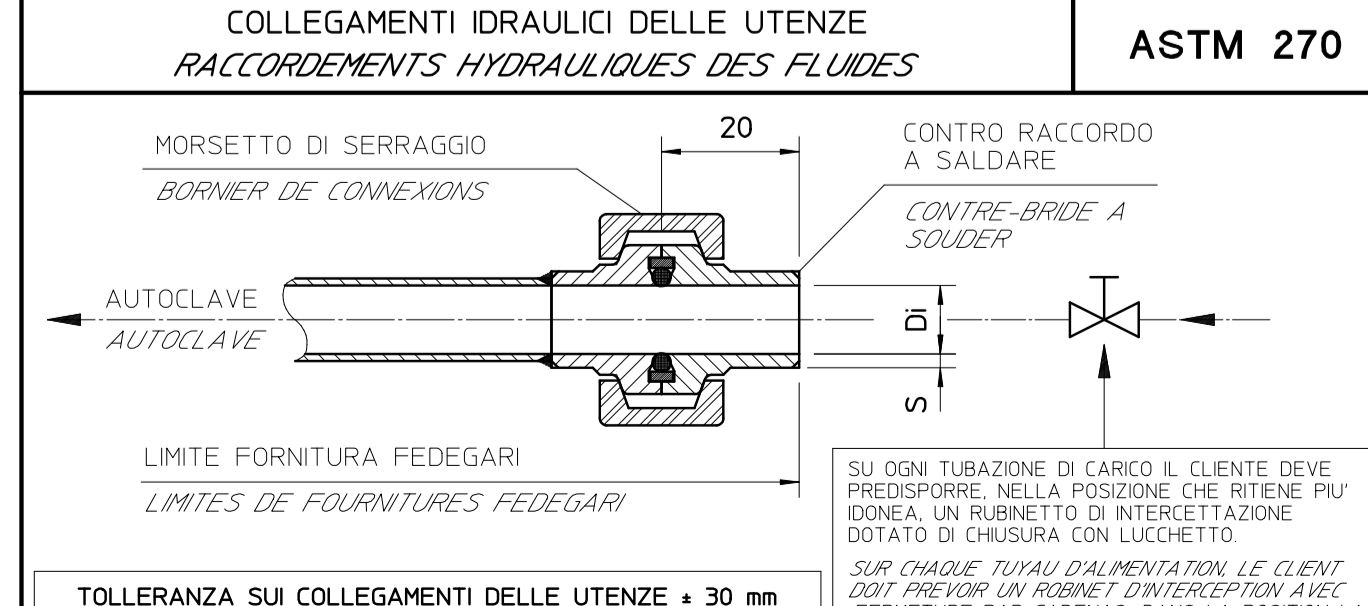

DISIPAZIONE TERMICA (INDICATIVA), PORTE CHIUSE	LATO 1 / ZONE 1	0,8 kW
DISIPAZIONE TERMICA (INDICATIVA), PORTE FERMEES	LATO 2 / ZONE 2	0,8 kW
	ZONA TECNICA / ZONE TECHNIQUE	10,5 kW
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO		CHAMBER
PRESSION DE MARCHÉ MAX		3 bar g
PESO INDICATIVO AUTOCLAVE VUOTA		5000 kg
POIDS INDICATIF AUTOCLAVE VIDE		
PESO AUTOCLAVE VUOTA GRAVANTE SULLA BASE D'APPOGGIO	R	S
POIDS SUR BASE D'APPUI AUTOCLAVE VIDE	3900 kg	1100 kg
PESO AUTOCLAVE IN PROVA IDROSTATICA GRAVANTE SULLA BASE D'APPOGGIO	R	S
POIDS SUR BASE D'APPUI AUTOCLAVE EN EPREUVE HYDROSTATIQUE	10600 kg	1100 kg

L ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ALIMENTATION ELECTRIQUE					
400 V ± 10% 3~+PE 50Hz		E' RESPONSABILITA' DEL CLIENTE CHE TUTTI GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI VENGANO ESEGUITI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE LOCALI.			
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AUTOLIMITATORE		C'EST A LA RESPONSABILITE DU CLIENT QUE TOUS LES RACCORDS ELECTRIQUES SOIENT REALISES SELON LA LOI EN VIGUEUR DU PAYS.			
INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE AUTOLIMITEUR					
(fourni et installe par le client)					

ALLACCIAMENTO UTENZE / RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS					
RIF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	RICHIESTA / DEMANDE		DISPONIBILE / DISPONIBLE	
		PRESSIONE / PRESSION (bar gl)	PORTATA / DEBIT	PRESSIONE / PRESSION (Di x S)	PORTATA / DEBIT
G1	RECUPERO ACQUA RAFFREDDAMENTO / RECOUVREMENT EAU REFROIDISSEMENT	1,5	70-80l/min	22,1x1,65	
*G	ACQUA RAFFREDDAMENTO PIASTRE E SCARICO / EAU POUR REFROIDISSEMENT PLAQUES ET DECHARGE	2	70-80l/min	22,1x1,65	
E1	VAPORE INDUSTRIALE (95-97%) CONFORME A EN 285 TABELLA B1 / VAPEUR INDUSTRIELLE (95/97%) CONFORME A EN 285 TABELLA B1	3,5	550 kg/h	47,5x1,65	
D	AIR COMPRESSA DISOLEATA / AIR COMPRESSE DESHULEE	5,5	2000 NI/min	34,8x1,65	
A	SCARICO GENERALE / DECHARGE GENERAL			47,5x1,65	
*	CONFORM TO EN 285 (DN 50/50) CHLORINE < 80mg/l				
*	HARDNESS < 0,3 mmol/l (pH 6,5-8)				
A1	POSIZIONE DEGLI ATTACCHI NEL PAVIMENTO RESISTENTI AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 80° C E A 2,5 barg. IL COLLEGAMENTO CON 'A' E' A CURA DEL CLIENTE. / POSITION DES CONNEXIONS DES ALIMENTATIONS DU SOL, RESISTANTES A UNE TEMPERATURE MAX. DE 80° C ET 2,5 barg. LA CONNEXION AVEC 'A' EST AU SOIN DU CLIENT.			MN DN 50	

FEDEGARI ENGINEERING DEPARTMENT
AUTOGLAM S.P.A.
CERTIFIED CONSTRUCTION DRAWING
 DATE 15/03/13 APPROVED BY [Signature]
 Approval of the Layout does not prevent the manufacturer to implement, during construction, little changes to the dimensions, without impacting on the overall dimensions of the machine, without resubmitting the drawing for approval.

CUSTOMER	JANSSEN		AGENT/DISTRIBUTOR	STERIGENE SAS	
MACHINE	FOA5/GB THEMA4 900x1300x3100		Scale	1:8	
DESCRIPTION	PLAN DE INSTALLATION		Des	Lus	
	Date 30/11/2012		DFK	DWG NO. GA012527	
Classe di appartenenza : disegni_install					